

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目の検査委託先より、測定機器の変更に伴い測定試薬および検体量等
が変更される旨の連絡がありましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目 コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
38	2152	カテコールアミン 3分画〈尿〉	検査方法	HPLC [東ソー]	HPLC	測定機器の変更 に伴う検査要項 の見直し A : アドレナリン NA: ノルアドレナリン DA: ドーパミン
			検体量	酸性蓄尿 1.0mL	酸性蓄尿 5.0mL	
			報告下限値	A 0.5 μg/L NA 0.4 μg/L DA 2 μg/L	A 0.6 μg/L NA 1.1 μg/L DA 11 μg/L	
	2156	遊離カテコールアミン 3分画	検査方法	HPLC [東ソー]	HPLC	
			検体量	酸性蓄尿 1.0mL	酸性蓄尿 5.0mL	
			報告下限値	A 0.5 μg/L NA 0.4 μg/L DA 2 μg/L	A 0.6 μg/L NA 1.1 μg/L DA 11 μg/L	
-	2302	カテコールアミン 3分画〈随時尿〉	検査方法	HPLC [東ソー]	HPLC	
			検体量	酸性蓄尿 1.0mL	酸性蓄尿 5.0mL	
			報告下限値	A 0.5 μg/L NA 0.4 μg/L DA 2 μg/L	A 0.6 μg/L NA 1.1 μg/L DA 11 μg/L	

※新旧二法の相関につきましては、裏面をご参照下さい。


■変更期日

2014年11月1日(土)受付日分より


以上

■新旧二法の相関


【アドレナリン】

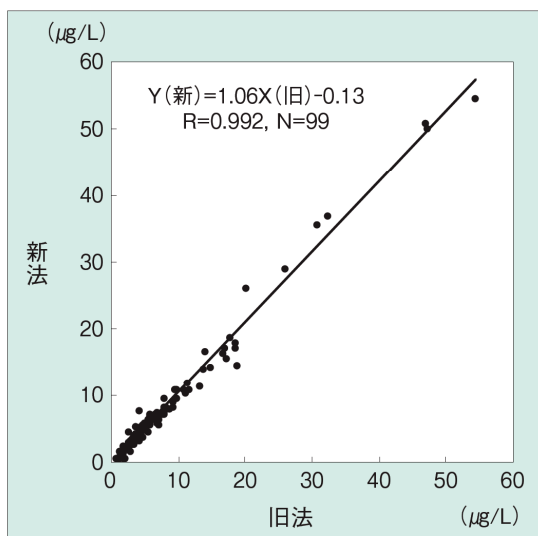

【ノルアドレナリン】

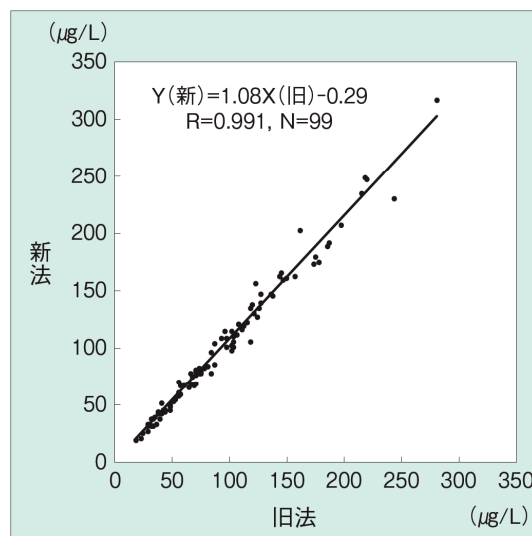

【ドーパミン】

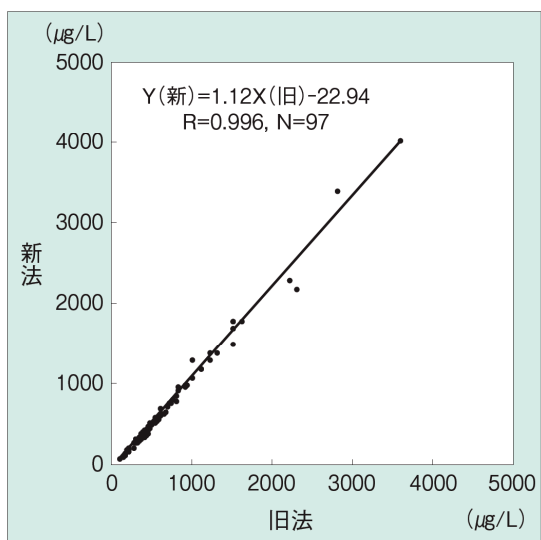

(LSI 検討データ)