

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
112	1567	NAG (N-アセチル グルコサミニターゼ)	検査材料 検体量	部分尿 0.5 mL (<u>蓄尿を中止</u>)	部分尿 0.5 mL 蓄尿 0.5 mL
			基準値 (単位)	部分尿 0.7~11.2 (<u>IU/L</u>)	部分尿 7.0 以下 蓄尿 7.0 以下 (U/L)
			報告範囲	0.4 未満、 0.4~999999.9	0.1 未満、 0.1~999999.9

※:その他検査要領に変更はございません。

※:詳細および新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

■変更期日

- 2015年7月4日(土)受付分より

以上

NAG(N-アセチルグルコサミニダーゼ)


検査委託先におきまして、現測定試薬販売中止に伴い、測定試薬を変更させていただきます。
 検査方法は変更ありませんが、基準値、単位および報告範囲が変更となります。
 また、本変更に伴い、蓄尿材料での受託は中止とさせていただきます。

■検査要領

項目コード	1567
検査項目名	NAG(N-アセチルグルコサミニダーゼ)
検体量	部分尿 0.5 mL
容器	Y9
所要日数	3~6日
実施料	41点
判断料	34点(尿・糞便等検査判断料)
検査方法	比色法
基準値(単位)	0.7~11.2 (IU/L)
報告範囲	0.4未満、0.4~999999.9
備考	(なし)
検査場所	エスアールエル (→5)

下線部が変更となった箇所です。

■新旧二法の相関

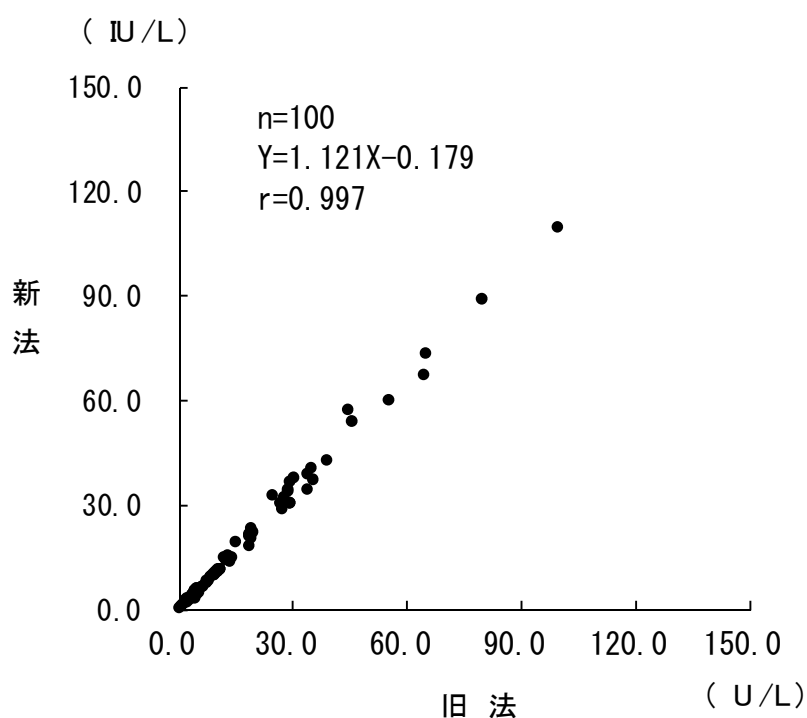

(SRL 検討データ)