

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■検査内容変更対象項目

- [2266] ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP)
- [3738] 抗 SS-A/Ro 抗体 [ELISA]
- [3742] 抗 SS-B/La 抗体 [ELISA]

※変更内容の詳細は次頁以降をご参照下さい。

■変更期日

- 2015年12月17日(木)受付日分より

以上

●検査内容変更一覧


頁	項目 コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
44	2266	ヒト心房性ナトリウム 利尿ペプチド (HANP)	報告範囲	5.0未満、5.0～1990、 2000以上	5.0以上、5.1～1290、 1300以上
			参考文献	松岡 泰弘, 他: 医療と 検査機器・試薬 33(4): 535～540, 2010.	下迫 賢一, 他: 医学と 薬学 57(6): 901～906, 2007.
81	3738	抗 SS-A/Ro 抗体	検査項目名	抗 SS-A/Ro 抗体 [CLEIA]	抗 SS-A/Ro 抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値 (単位)	10.0未満 (U/mL)	10.0以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0未満、1.0～1190、 1200以上	7.0以下、7.1～499、 500以上
			備考	不活化(非働化)検体で はデータ影響を及ぼす 場合がありますので避 けて下さい。	(記載なし)
参考文献	西山 進, 他: 医学と薬 学 68(2): 345～355, 2012.	秋月 正史, 他: 医学と 薬学 37(2): 509～520, 1997.			
82	3742	抗 SS-B/La 抗体	検査項目名	抗 SS-B/La 抗体 [CLEIA]	抗 SS-B/La 抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値 (単位)	10.0未満 (U/mL)	10.0以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0未満、1.0～999、 1000以上	7.0以下、7.1～499、 500以上
			備考	不活化(非働化)検体で はデータ影響を及ぼす 場合がありますので避 けて下さい。	(記載なし)
参考文献	西山 進, 他: 医学と薬 学 68(2): 345～355, 2012.	秋月 正史, 他: 医学と 薬学 37(2): 509～520, 1997.			

※その他検査要領に変更はございません。

ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)

現行試薬の販売中止に伴い、同等性能の測定試薬に変更し報告範囲を再設定いたします。
なお、基準値に変更はございません。

■新旧二法の相関


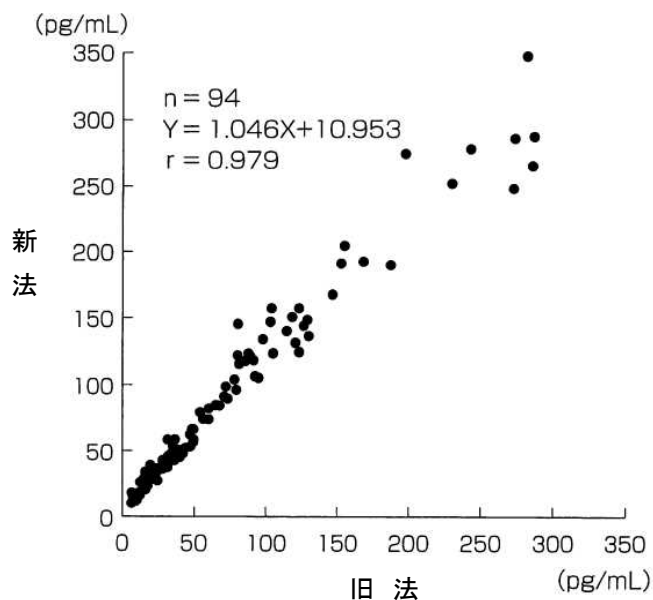


(SRL 検討データ)

抗 SS-A/Ro 抗体 抗 SS-B/La 抗体

現試薬の販売中止に伴い、CLEIA試薬に変更させていただきます。新基準値はメーカー設定値です。

■新旧二法の相関

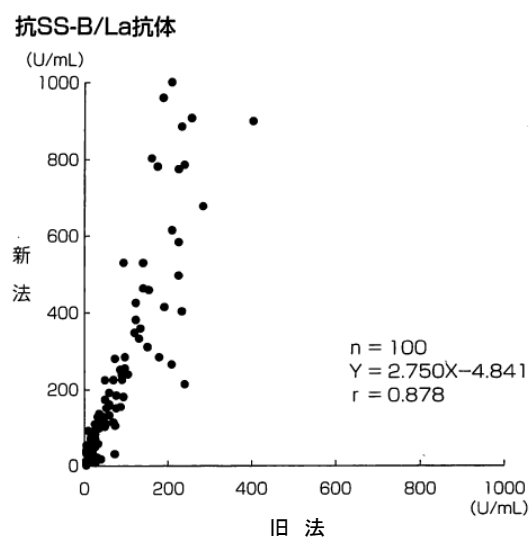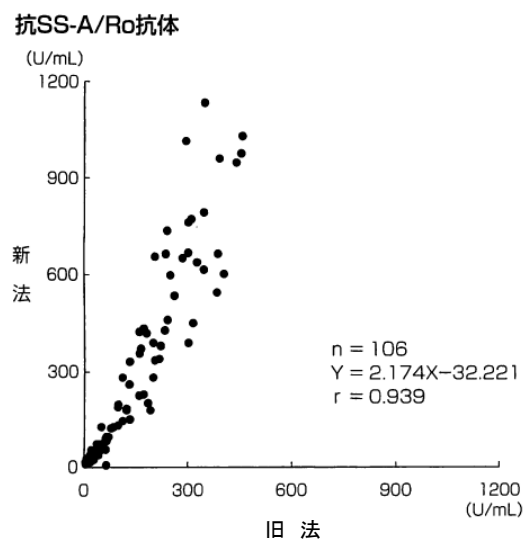

(SRL 検討データ)