

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、尿検査などに使用する蛋白定量試薬を、従来の用手法用から自動分析装置用へ変更することとしました。

つきましては、この試薬変更による検査内容変更をご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
51 128	7015	(尿検査) 蛋白定量	検査方法	ピロカロール・レット法 自動分析機用	ピロカロール・レット法 用手法用
			報告値下限	3 mg/dL* ¹	なし
52 130	7206	(髄液検査) 蛋白定量	検査方法	ピロカロール・レット法 自動分析機用	ピロカロール・レット法 用手法用
			報告値下限	3 mg/dL* ¹	なし

*1: 報告値下限を下回った場合は「3未満」と報告し、蛋白定量1日量・尿蛋白/クレアチニン比を「計算不可」と報告いたします。

※その他の検査要領に変更はございません。


※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

■変更期日

●2017年11月20日(月)受付日分より

以上

■新旧二法の相関

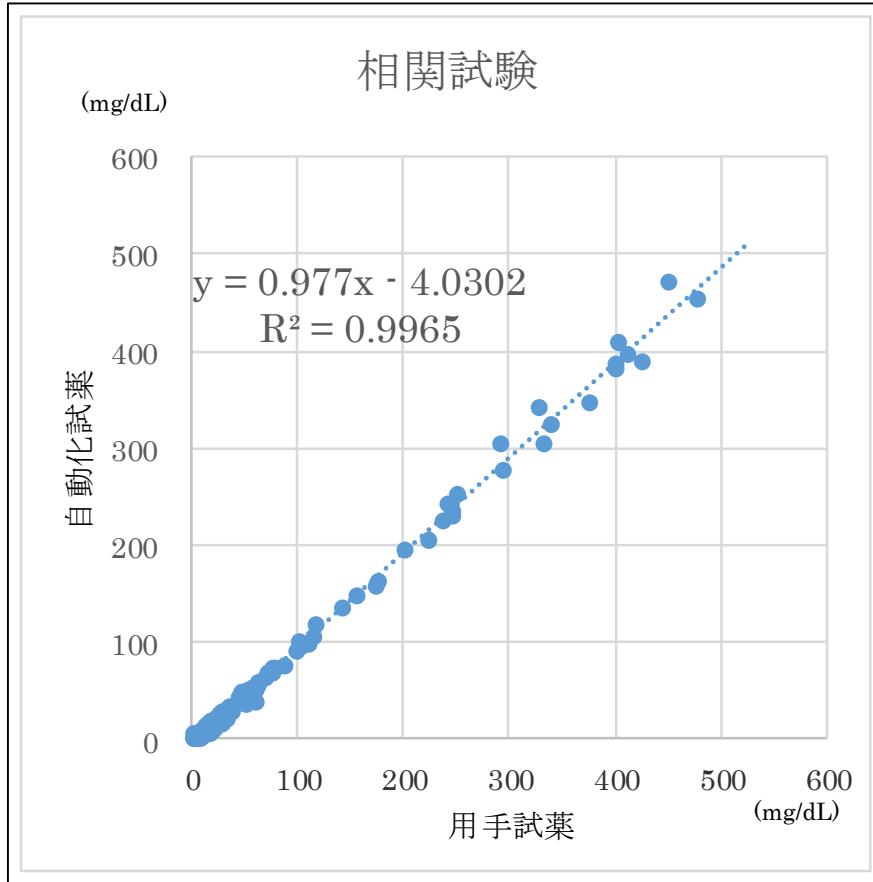

(n=160)

(自社検討データ)