

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、HBs抗体測定試薬の仕様変更に伴い、下記のとおり検査内容変更をご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
84	3124	HBs抗体 〔精密測定〕	基準値	10.0未満(mIU/mL) <u>根拠を明確化</u> * <sup>1</sup>	10.0未満(mIU/mL) 根拠表現無し
			報告可能範囲	<u>2.5</u> ~1000.0* <sup>2</sup>	10.0~1000.0

※その他の検査要項に変更はございません。

※今回の仕様変更では、測定値の値付けを行うWHO標品が1stから2ndに変更されました。これにより、測定値が高値傾向となります。

※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

\*1: 10.0mIU/mLは、HBVワクチンの再接種基準のためのカットオフ値です(最少防御抗体価)。

\*2: 報告範囲の下限が10.0から2.5に拡大されます。従来「10.0未満」と報告されているものは、2.5までが実数報告となり、2.5を下回る場合に「2.5未満」と報告いたします。また、定性判定は\*1に従い、10.0未満を陰性(ー)と判定いたします。


#### ■変更期日

●2018年4月2日(月)受付日分より

## ■新旧二法の相関

【全体】

(n=52)

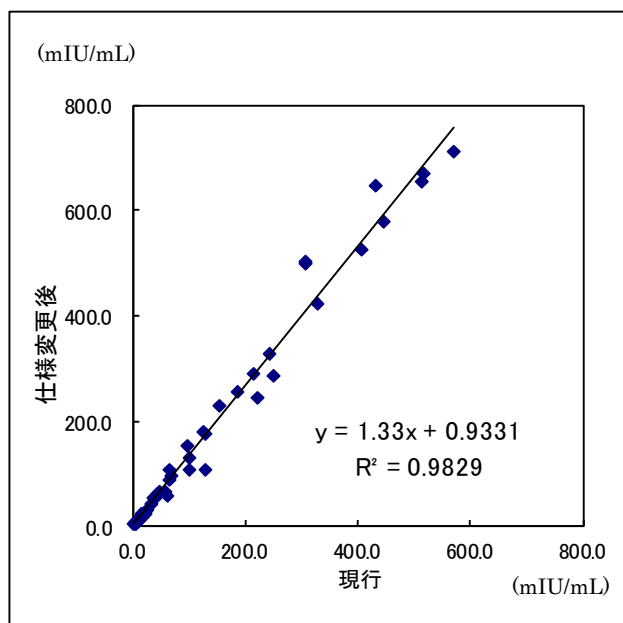

【低値域】

(n=26)

