

「炭酸リチウム」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきまして、現行測定機器の部品製造中止により測定機器ならびに検査方法を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

この度の検査方法変更に伴い、報告下限値および報告上限値が変更され、報告可能範囲が拡大いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
123 141	2001	炭酸リチウム	検査方法	比色法	電極法
			報告下限値	0.01 mEq/L	0.13 mEq/L
			報告上限値	6.30 mEq/L	5.50 mEq/L

※その他の検査要項に変更はございません。
※新旧二法の相関につきましては、裏面をご確認ください。

■変更期日

●2021年12月13日(月)受付日分より


以上

炭酸リチウム

現行測定機器の部品製造中止により測定機器ならびに検査方法を変更させていただきます。

この度の検査方法変更に伴い、報告下限値および報告上限値が変更され、報告可能範囲が拡大いたします。

■新旧二法の相関

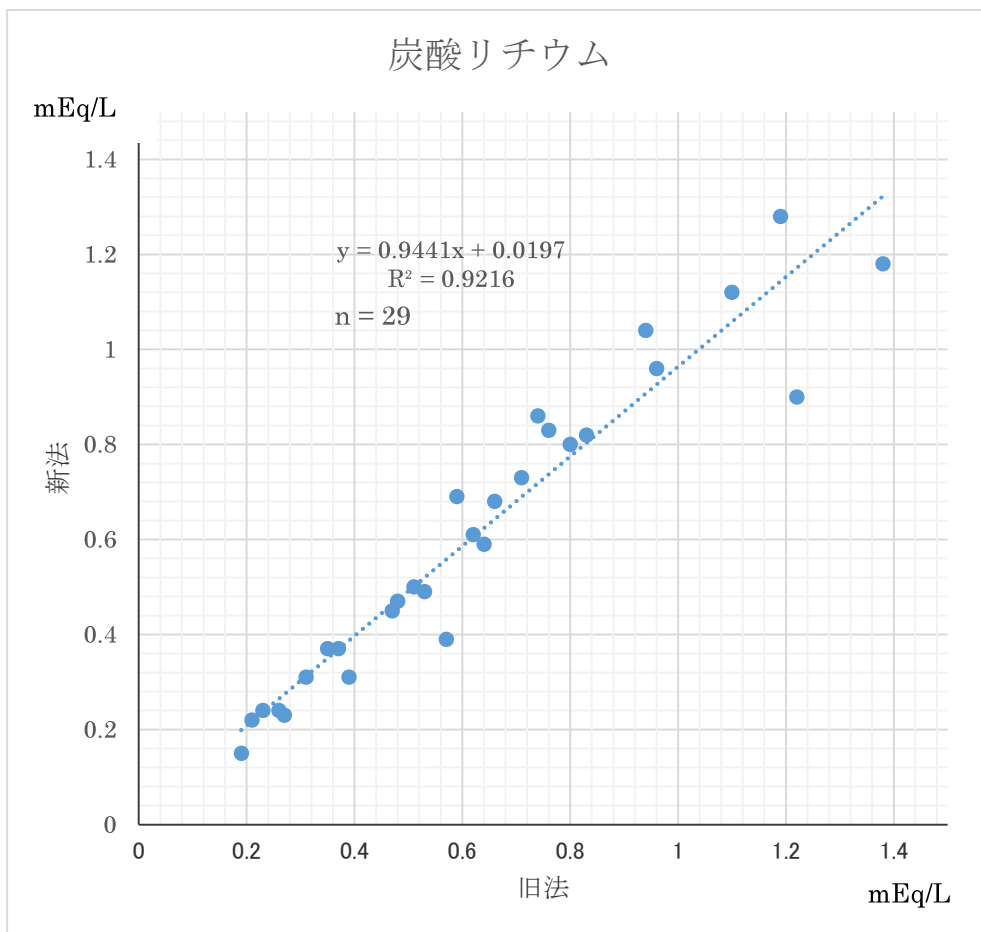

(自社検討データ)