

検査内容変更および検査中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして測定機器の変更により検査内容を変更、及び中止させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
201 252	1001	血液一般	検査方法	フローサイトメトリー法	FCM 法
				電気抵抗検出法	2次元レーザー散乱光測定法
				SLS-Hb法	AAO 法+セルラーヘモグロビン法
				赤血球パルス波高値検出法	2次元レーザー散乱光測定法
				電気抵抗検出法	2次元レーザー散乱光測定法
				計算法	(同左)
				計算法	(同左)
				計算法	(同左)
-	-	RDW-CV(赤血球分布幅)	電気抵抗検出法	2次元レーザー散乱光測定法	
201 252	1021	網状赤血球数(レチクロ)	フローサイトメトリー法	(同左)	
202 253	1030	白血球像	自動血球分類装置使用 (フローサイトメトリー法) 鏡検法	自動血球分類装置使用 (FCM 法+ペルオキシダーゼ 活性法)鏡検法	

- ※ その他の検査要項に変更はございません。
※ 新旧二法の相関は次頁以降をご確認下さい。

■検査中止項目

頁	項目コード	検査項目名	中止理由	代替項目
201	1028	網赤血球内ヘモグロビン含量(CHr)	測定機器変更のため	なし









■変更期日


●2023年5月29日(月)受付日分より

※検査中止項目[1028]網赤血球内ヘモグロビン含量(CHr)の最終受付日は2023年5月27日(土)です。


■新旧二法の相関

●[1001] 血液一般

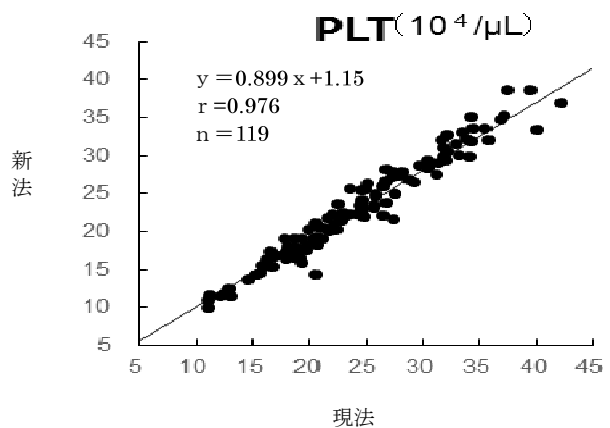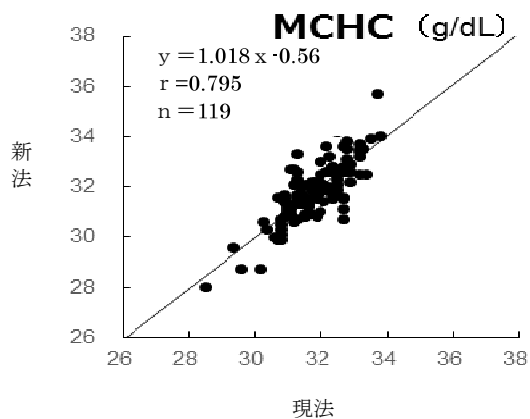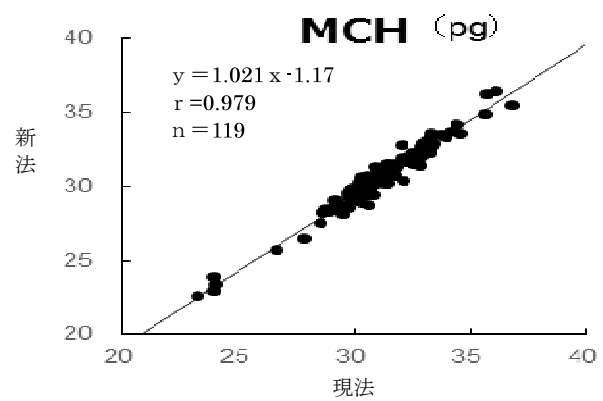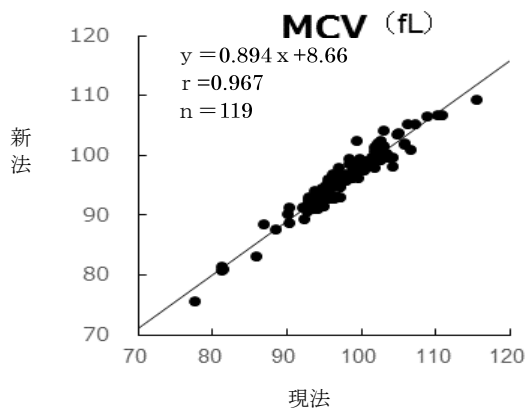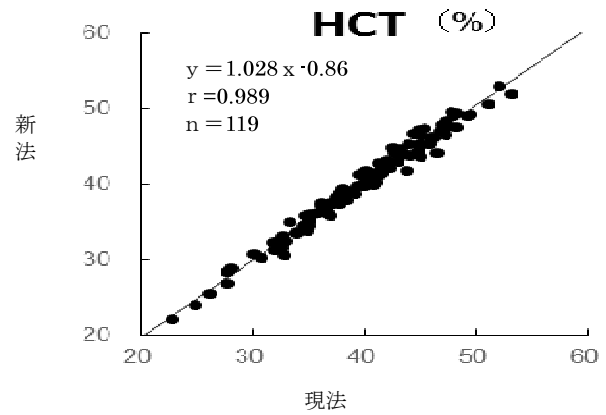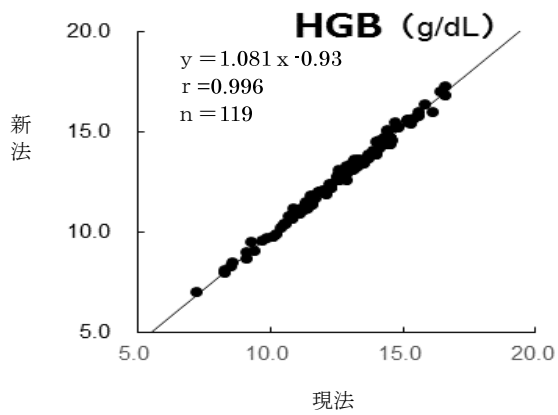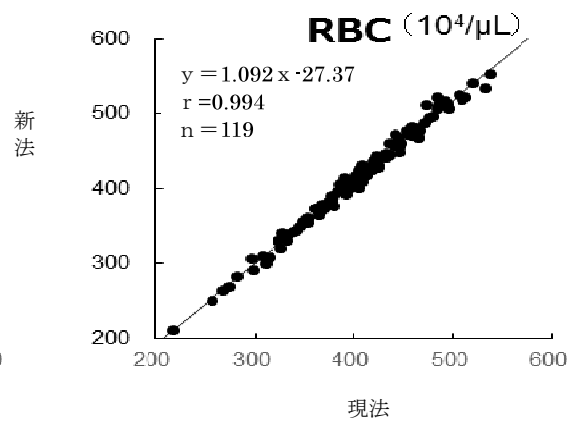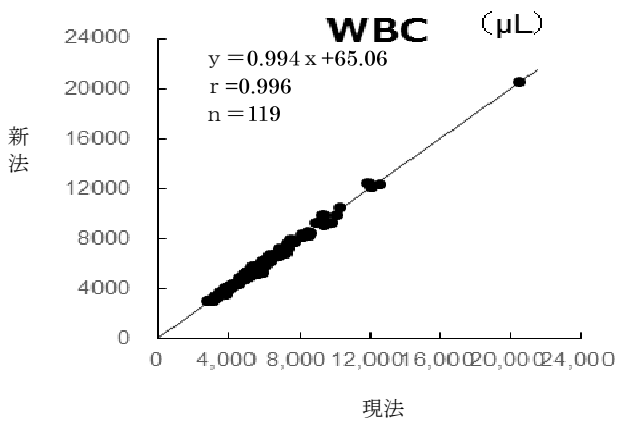

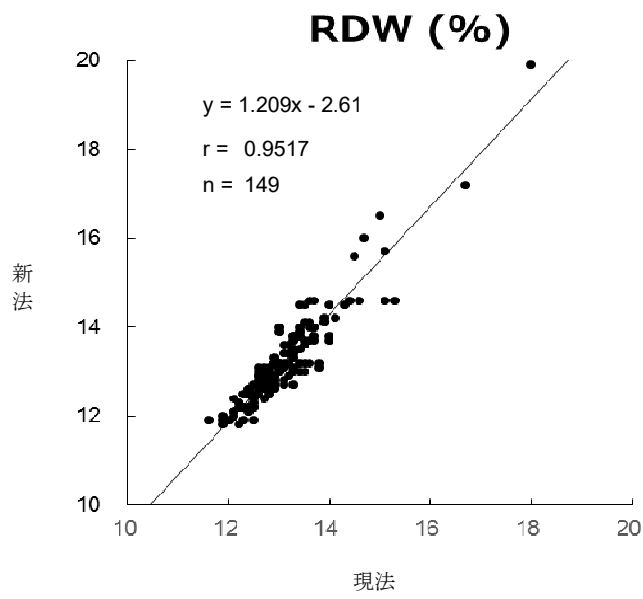

●[1021] 網状赤血球数(レチクロ)

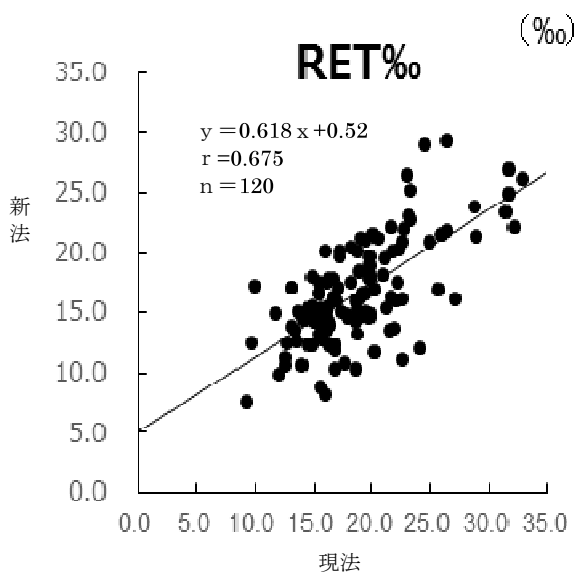

●[1030] 白血球像

